


# **Prestations Analytiques 2026**

V2 web

**Eaux et Environnement**

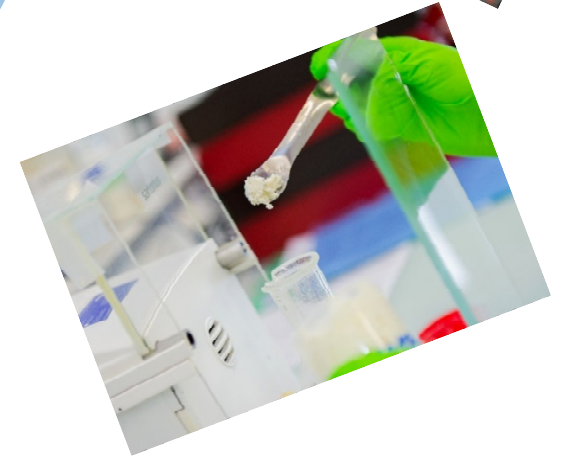

**AVEYRON  
LABO**

## UNITE TECHNIQUE EAUX ET ENVIRONNEMENT

### **Unité technique eau et environnement**

#### **Environnement / Qualité de l'eau / Analyses physico-chimiques**

*LAB GTA 05* Analyses physico-chimiques des eaux

### **Unité technique bactériologie des eaux**

#### **Environnement / Qualité de l'eau / Analyses microbiologiques**

*LAB GTA 23* Analyses microbiologiques des eaux

### **Unité technique prélèvement**

#### **Environnement / Qualité de l'eau / Echantillonnage – Prélèvement**

*LAB GTA 29*

Echantillonnage d'eau en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques

Essais physico-chimiques des eaux sur site

## Analyses d'eaux hors contrôle sanitaire ...

---

- \* Eaux destinées à la consommation humaine ou destinées à la production d'eau de consommation hors contrôle sanitaire obligatoire article R.1321 du Code de la Santé Publique
- \* Eaux de loisirs (piscines, baignades) hors contrôle sanitaire obligatoire
- \* Eaux usées
- \* Eaux industrielles
- \* Eaux pour soins standards, eaux d'entrée, eaux bactériologiquement maîtrisées, eaux physico-chimiques ...
- \* Eaux pour consommation animale
- \* Eaux pour usages particuliers
- \* Eaux souterraines, piézomètres
- \* Eaux superficielles
- \* Eaux de gachage pour béton
- \* Eaux chaudes sanitaires et installations de refroidissement (T.A.R)

Le prix hors T. V. A. des analyses s'obtient en faisant la somme des prestations analytiques et des frais divers (flaconnage, prise en charge ...).

Les délais indiqués correspondent aux délais analytiques incompressibles. Ils ne sont valables que pour les jours ouvrés (jours d'ouverture du laboratoire). Le délai de rendu de résultats correspond à J + 2 après la fin des analyses hors délais postaux. Les délais peuvent varier selon l'activité du laboratoire. Toutefois des résultats partiels peuvent être communiqués par fax ou par mail pour les analyses urgentes.

Pour toutes les analyses d'hydrologie le flaconnage est fourni par le laboratoire. Le client a la possibilité de les récupérer à l'accueil du laboratoire. Sinon, les frais d'envoi sont à la charge du client. Tous les prélèvements doivent obligatoirement être accompagnés d'une demande d'analyse dûment complétée par le client. Afin de garantir le délai de prise en charge, il est impératif de renseigner sur cette demande la date et l'heure de prélèvement. S'il y a, le numéro de référence du devis ou de la convention correspondant devra apparaître.

Les échantillons doivent arriver au laboratoire dans des conditions préservant la qualité du prélèvement et dans des quantités permettant l'analyse.

## Prélèvement

### Hydrologie :

- Pour une recherche de potabilité, remplir sans bulle d'air un flacon d'1 litre.
- Pour les eaux usées et autres demandes, le service commercial ou le service hydrologie vous indiquera le flaconnage et la quantité nécessaire.

### Bactériologie des eaux :

- Pour une recherche de potabilité, remplir jusqu'à la graduation le flacon de 500mL en ayant pris soin de désinfecter le point de prélèvement.
- Pour une recherche de légionelles, remplir jusqu'à la graduation le flacon de 500mL pour les Eaux Chaudes Sanitaires (ECS) et le flacon de 1L pour les installations de refroidissement (TAR) en ayant pris soin de désinfecter le point de prélèvement. Si l'ECS est colorées ou présente des matières en suspension, prélever 1L.
- Pour une recherche de Salmonelles et de Listeria, prélever 5L pour chaque recherche.

Tous les échantillons doivent être conservés à  $5 \pm 3^\circ \text{C}$  jusqu'à réception au laboratoire (à température ambiante pour la recherche de légionelles).

## Délai de prise en charge

### Hydrologie :

Dans le cas de prélèvements d'eau, un délai de 24 heures doit être respecté pour la majorité des paramètres entre l'heure de prélèvement et l'heure de réception au laboratoire.

### Bactériologie des eaux :

- Pour la recherche des *Escherichia coli*, des bactéries coliformes et des Entérocoques intestinaux : l'échantillon doit être analysé au plus tard **18 heures** après le prélèvement.
- Pour la recherche des bactéries aérobies revivifiables à  $22^\circ$  et à  $36^\circ$  : l'échantillon doit être analysé au plus tard **12 heures** après le prélèvement.
- Pour la recherche des légionelles : l'échantillon doit être analysé au plus tard le lendemain du prélèvement.

Tous les échantillons doivent parvenir au laboratoire avant le jeudi 17h. Lorsque les critères d'acceptation des échantillons à réception ne sont pas conformes (quantité insuffisante, conditionnement...), le client sera contacté afin de décider de la poursuite des analyses.

## Cas particulier pour les MES

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Pour des raisons analytiques, certains échantillons arrivant le vendredi après 15h ne pourront être analysés que le lundi suivant. Le dossier sera rendu Non Cofrac et sous réserve si une stabilisation n'est pas possible (modalités paragraphe 17).

## Aveyron Labo est accrédité pour réaliser les prélèvements suivants

- Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques sur les eaux destinées à la consommation humaine sur les eaux de loisirs naturelles (baignades) et traitées (piscines...), sur les eaux superficielles continentales (rivières, lacs), sur les eaux souterraines et sur les eaux usées.
- Echantillonnage pour la recherche de légionelles sur les installations de refroidissement et sur les eaux chaudes sanitaires.

Accréditation n° 1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) <<http://www.cofrac.fr>> :

**Programme « Analyses physico-chimiques des eaux » (LAB GTA 05), « Analyses microbiologiques des eaux » (LAB GTA 23) pour l'hydrologie et « Prélèvement et mesure sur site » (LAB GTA 29).**

Pour tout changement dans le secteur hydrologie (réglementation et critères) les paramètres analysés pour les matrices Eaux propres suivront l'article R.1321 du code de la Santé Publique, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. La portée de l'accréditation concernant ces programmes vous sera communiquée sur simple demande.



## Analyses Chimiques de base

C : paramètre accrédité COFRAC

Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Paramètre	Cofrac	Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
<b>Absorbance UV à 254 nm TUV</b>		Mesure à 254 nm	5 J
<b>Agents de surface anioniques (SABM) DETA</b>	C	NF EN 903	8 J
<b>Ammonium par Colorimétrie (EP) NH4IN</b>	C	NF T 90-015-2	1 J
<b>Ammonium par Distillation (EU) NH4di</b>	C	NF T 90-015-1	1 J
<b>Ammonium (Eaux douces) Spectométrie automatisée NH4SEQ</b>	C	NF ISO 15923-1	1 J
<b>Anhydride carbonique libre (CO2)</b>		HALLOPEAU	10 J
<b>Aspect (couleur, odeur) : qualitatif</b>			1 J
<b>Azote Kjeldahl NTK</b>	C	NF EN 25663	4 J
<b>Bromates (BrO3) Brate</b>	C	NF EN ISO 15061	5 J
<b>Bromures Brure</b>	C	NF EN ISO 10304-1	5 J
<b>Carbonates (Alcalinité Composite) TA</b>	C	NF EN ISO 9963-1	1 J
<b>Carbone Organique Dissous COD</b>	C	NF EN 1484	7 J
<b>Carbone Organique Total COT</b>	C	NF EN 1484	7 J
<b>Chlorates Clate</b>	C	NF EN ISO 10304-4	5 J
<b>Chlorites Clite</b>	C	NF EN ISO 10304-4	5 J
<b>Chlorophylle a et Phéopigments</b>	C	NF T 90-117	15 J
<b>Chlorures (EP) CLCI</b>	C	NF EN ISO 10304-1	7 J
<b>Chlorures (Eaux douces) Spectométrie automatisée CLSEQ</b>	C	NF ISO 15923-1	7 J

<b>Chlorures (Volumétrie) (EU + Piscines) CLTIT</b>	<b>C</b>	<b>NF ISO 9297</b>	<b>7 J</b>
<b>Chrome hexavalent Cr6 (Eaux douces et résiduaires)</b>	<b>C</b>	<b>NF T 90-043</b>	<b>5 J</b>
<b>Chrome hexavalent Cr6 (Eaux douces et résiduaires)</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 23913</b>	<b>5 J</b>
<b>Conductivité Cdt25</b>	<b>C</b>	<b>NF EN 27888</b>	<b>1 J</b>
<b>Couleur (quantitatif)</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 7887 Méthode D</b>	<b>2 J</b>
<b>Cyanures Totaux CYANTOT (avec digestion)</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 14403-2</b>	<b>10 J</b>
<b>Cyanures Libres CYANL</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 14403-2</b>	<b>10 J</b>
<b>Demande biochimique en oxygène (3 dilutions) DBO5</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 5815-1 ou NF EN 1899-2</b>	<b>7 J</b>
<b>Demande chimique en oxygène DCO</b>	<b>C</b>	<b>NF T 90-101</b>	<b>1 J</b>
<b>Equilibre calco-carbonique (agressivité)</b>		<b>Legrand Poirier</b>	<b>10 J</b>
<b>Fluorure F</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 10304-1</b>	<b>7 J</b>
<b>Hydrogénocarbonates (Alcalinité Totale) TAC</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 9963-1</b>	<b>1 J</b>
<b>Indice permanganate MOAC</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 8467</b>	<b>2 J</b>
<b>Indice phénol avec distillation IPHEN</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 14402</b>	<b>12 J</b>
<b>Masse Volumique DENSITE</b>		<b>Méthode Interne</b>	<b>7 J</b>
<b>Matières en suspension par centrifugation MESC</b>	<b>C</b>	<b>NF T 90-105-2</b>	<b>2 J</b>
<b>Matières en suspension par filtration MESF</b>	<b>C</b>	<b>NF EN 872</b>	<b>2 J</b>
<b>Matières organiques (et/ou) minérales MVS</b>		<b>CALCINATION 550°</b>	<b>5 J</b>
<b>Nitrates NO3</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 10304-1</b>	<b>4 J</b>
<b>Nitrates (Eaux douces) Spectométrie automatisée NO3SEQ</b>	<b>C</b>	<b>NF ISO 15923-1</b>	<b>4 J</b>
<b>Nitrites NO2</b>	<b>C</b>	<b>NF EN ISO 10304-1</b>	<b>4 J</b>
<b>Nitrites (Eaux douces) Spectométrie automatisée NO2SEQ</b>	<b>C</b>	<b>NF ISO 15923-1</b>	<b>4 J</b>

C : paramètre accrédité COFRAC

 Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

<b>Orthophosphates <i>PO4</i></b>	<b>C</b>	NF EN ISO 6878	7 J
<b>Orthophosphates <i>PO4 en Cl</i></b>	<b>C</b>	NF EN ISO 10304-1	7 J
<b>Orthophosphates <i>PO4</i> (Eaux douces) Spectométrie automatisée <i>PO4SEQ</i></b>	<b>C</b>	NF ISO 15923-1	7 J
<b>Ph à 20°C <i>pH20</i></b>	<b>C</b>	NF EN ISO 10523	1 J
<b>Potentiel Redox</b>		NF T90-260	1 J
<b>Résidus secs à 105° C <i>RSEC105</i></b>	<b>C</b>	NF T 90-029	3 J
<b>Substances extractibles au chloroforme <i>SEC</i> ou à l'hexane <i>SEH</i></b>		Méthode interne (basé sur RODIER)	7 J
<b>Sulfates <i>SO4</i></b>	<b>C</b>	NF EN ISO 10304-1	7 J
<b>Sulfates (Eaux douces) Spectométrie automatisée <i>SO4SEQ</i></b>	<b>C</b>	NF ISO 15923-1	7 J
<b>Sulfures après extraction (volumétrie) <i>S</i></b>		RODIER	5 J
<b>Titre hydrométrique (Dureté) <i>TH</i></b>	<b>C</b>	NF T 90-003	5 J
<b>Turbidité <i>TURB</i></b>	<b>C</b>	NF EN ISO 7027-1	1 J

C : paramètre accrédité COFRAC  
 Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Analyse Chimique Dosage de métaux

**Délais analytiques en jours ouvrés : 10 J**

Paramètre	Cofrac	Référence de la Méthode
<b>DOSAGE ICP AES (Eaux douces, Eaux résiduaires)</b> Al, Ba, Be, B, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, K, P, Se, Si, Na, S, Sr, Ti, V, Zn	C	Minéralisation : Méthode Interne GOMINEICP  Dosage : Méthode interne 406EAUXICPAES.doc
<b>DOSAGE ICP MS (Eaux douces, Eaux résiduaires)</b> Ag, Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd, Li, Mn, Mo, Sn Ni, P, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Te, Tl, Ti, U, V, Zn + Hg ( <i>uniquement sur Eaux résiduaires</i> ) + Ca, Mg, K, Na ( <i>uniquement sur Eaux douces</i> )	C	Minéralisation : Méthode Internes GOMINEICP  Dosage : Méthode interne 406EAUXICPMS.doc
<b>DOSAGE Hg par AFS (Eaux douces)</b> <i>Minéralisation incluse</i> Hg	C	Fluorescence atomique NF EN ISO 17852
<b>Frais divers :</b> <b>Minéralisation pour analyses ICP</b> <i>Un coût supplémentaire de 8.71 euros HT sera facturé par matrice, quel que soit le nombre de métaux demandé.</i> <b>Minéralisation supplémentaire si Ag, Sn, Hg sur Eaux Résiduaires.</b>		Méthode Interne GOMINEICP

C : paramètre accrédité COFRAC

Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Analyse Organique

Paramètre	Cofrac	Référence de la Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
Benzène et aromatiques BTEX (GC/MS) <i>Eaux douces</i> <i>Benzène et aromatiques : Benzène et Toluène, Méta+Para-xylène, Ortho-xylène, Ethylbenzène</i>	C	Méthode Interne 403COVHSGCMS.doc	5 J
Composés Organohalogénés Volatils (GC/MS) <i>Eaux douces</i> <i>Chloroforme, 1-2 dichloroéthane, trichloroéthylène, Bromodichlorométhane, Tétrachloroéthylène, Dibromochlorométhane, Bromoforme</i>	C	Méthode Interne 403COVHSGCMS.doc	5 J
THM (Bromoforme, chloroforme, dibromochlorométhane, dichlorobrométhane) Eaux de piscine	C	Espace de tête statique et dosage par GC/MS Méthode interne 403COVHSGMS**.doc	5 J
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dans l'eau par HPLC/fluorescence <i>Eaux douces</i> <i>Acénaphène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, 2-méthylfluoranthène, Benzo(a)Anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(g,h,i) pérylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène, Fluorène, naphthalène, 1-méthylnaphtalène, 2-méthylnaphtalène</i>	C	NF EN ISO 17993	15 J
Chlorure de Vinyle (Chloroéthylène) <i>Eaux douces</i>	C	Espace de tête statique et dosage par GC/MS Méthode Interne 403COVHSGCMS**.doc	5 J

C : paramètre accrédité COFRAC

Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Paramètre	Cofrac	Référence de la Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
Indice Hydrocarbure par CG/FID <i>Eaux douces - Eaux résiduaires</i>	C	NF EN ISO 9377-2	15 J
Phytosanitaires Midi Pyrénées HCS_PHY20 (282 molécules)		<i>sous-traité LD31 EVA</i>	30 J

C : paramètre accrédité COFRAC

Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Liste des caractéristiques mesurées ou recherchées sur Eaux douces		
dichlorobrométhane, bromoforme, chloroforme, dibromochlorométhane, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, 1,2-dichloroéthane, chlorure de vinyle (chloroéthylène), chlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, 2-chlorotoluène, 3-chlorotoluène, 4-chlorotoluène, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, dichlorométhane, tétrachlorure de carbone, chloroprène (2-chloro-1, 3-butadiène), 3-chloroprène (3-chloropropène), 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dichloroéthylène cis, 1,2-dichloroéthylène trans, 1,2-dibromoéthane, 1,3-dichloropropène cis, 1,3-dichloropropène trans, 1,2,3-trichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, 1,3,5-trichlorobenzène, benzène, toluène, o-xylène, m+t xylène, méthyl ter-butyl éther (MTBE), éthylbenzène, isopropylbenzène, Bromométhane, 1,2-dichloropropane et Hexachlorobutadiène).	C	Méthode Interne 403COVHSGCMS.doc  5 J

## Environnement / Qualité de l'eau / Analyses microbiologiques

Paramètre	Cofrac	Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
<b>Bactéries aérobies revivifiables (à 22°C) GT22</b> <i>Si dilution : Rajouter frais supplémentaire Réf. Diplabo E'DIL% : 8.41 € HT</i>	C	NF EN ISO 6222	3 J
<b>Bactéries aérobies revivifiables (à 36°C) GT36</b> <i>Si dilution : Rajouter frais supplémentaire Réf. Diplabo E'DIL% : 8.41 € HT</i>	C	NF EN ISO 6222	2 J
<b>Entérocoques (par microplaque NPP96) EU STRNPP</b>	C	NF EN ISO 7899-1	2 J
<b>Entérocoques (sur membranes filtrantes) EA STRP</b>	C	NF EN ISO 7899-2	2 J
<b>Escherichia coli (par microplaque NPP96) EU E.coli</b>	C	NF EN ISO 9308-3	2 J
<b>Escherichia coli et Bactéries coliformes</b>	C	NF EN ISO 9308-1 de Septembre 2000	2 à 3 J
<b>Legionella spp (dont identification Legionella pneumophila Forfait CAMPHOT *</b>	C	NF T 90-431 + Amplification génique (Méthode interne 6legio**.doc)	11 à 13 J
<b>Legionella spp ((dont identification Legionella pneumophila) TAR</b>	C	NF T 90-431 + Amplification génique (Méthode interne 6legio**.doc)	11 à 13 J
<b>Listeria</b>		ALOA One Day AES10/3-09/00	3 à 5 J
<b>Pseudomonas aeruginosa (dénombrement) PSA</b>	C	NF EN 16266	2 à 8 J
<b>Salmonelles (recherche qualitative avec identification)</b>	C	NF EN ISO 19250	5 à 8 J
<b>Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices ANAE</b>	C	NF EN 26461-2	2 J
<b>Staphylocoques pathogènes</b>	C	NF T90-412	2 J

**\* prise en charge et flaconnage compris**

C : paramètre accrédité COFRAC

Accréditation n°1-1706, Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Analyses de Déchets HT

### Caractérisation des déchets en vue de revalorisation agricole Application de l'arrêté du 08/01/98

Paramètre	Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
Préparation de l'échantillon (Broyage+tamisage à 315 mm)		
<b>pH eau</b>	NF EN 12176	1 J
<b>Carbone organique - <i>COTBOUE</i></b>	NF ISO 14235	20 J
<b>Matière sèche - <i>MST</i></b>	NF EN 12880	20 J
<b>Matière Organique (Calcination à 525° C) - <i>MVSBOUE</i></b>	Calcination 525° C	20 J
<b>Azote Total Kjeldhal - <i>NTKBOUE</i></b>	NF EN 13342	20 J

## Micropolluants métalliques

**Délais analytiques en jours ouvrés : 20 J**

Prestations Analytiques	Méthode	Délai Analytique en jours ouvrés
Préparation + Minéralisation	Méthode Interne	
<b>Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc, Hg</b>	Méthodes Internes G406ECHANTILLON ET 406 EAUXICPAES ou Méthodes Internes G406ECHANTILLON ET 406 EAUXICPICPMS	20 J
<b>Prix unitaire hors minéralisation (ICP)</b>	Méthodes Internes G406ECHANTILLON ET 406 EAUXICPAES ou Méthodes Internes G406ECHANTILLON ET 406 EAUXICPICPMS	20 J

## Types Analyses : hors flaconnage, filtration et prise en charge

Désignation	Paramètres	Délai Analytique en jours ouvrés
B2P <b>Analyse Bactériologique Sommaire</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques	3 J
B2C1P <b>Analyse Extension de réseau</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Aspect qualitatif, Conductivité, pH, Turbidité	3 J
B3P <b>Analyse Bactériologique Complète</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	3 J
<b>B4P</b> <b>Analyse Bactériologique Complète + Pseudo.</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3 à 8 J
ANI <b>Analyse Bactériologique et Chimique pour consommation animale</b>	Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, pH, NH <sub>4</sub> , NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> , Dureté	5 J

<b>B3C2P</b> <b>Analyse Bactériologique et Chimique</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, Aspect, Conductivité, pH, Turbidité, NH <sub>4</sub> , NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> , Dureté, Chlorures	5 J
<b>B4C2P</b> <b>Analyse Bactériologique et Chimique + Pseudo.</b>	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C, Bactéries Coliformes et <i>Escherichia coli</i> , Entérocoques, Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, Aspect, Conductivité, pH, Turbidité, NH <sub>4</sub> , NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> , Dureté, Chlorures, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3 à 8 J
<b>PIS_PARTICULIERS_CHLORE</b> <b>Prélèvement et Analyse Eaux de Piscine pour particulier traitée au Chlore</b>	Forfait prélèvement + Mesures terrain (Acide isocyanurique, Chlore libre, Chlore disponible, Chlore total, pH à 20°, Chlore combiné, Chlore libre actif) + Carbone organique Total + Staphylocoques Pathogènes, <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> , Enterocoques, Chlorures, Bactéries aérobies revivifiables à 36°C.	5 J
<b>BAIMICROBIO - Baignades Microbiologie</b> <b>Microbiologie des eaux de baignades</b>	<i>Escherichia coli</i> et Enterocoques par microplaques ( NPP96 )	2 J
<b>BIL</b> <b>Bilan Station d'Epuration</b>	DBO, DCO, MESF, NTK, PT	10 J
<b>BSE</b> <b>Boues de Station d'Epuration</b>	Matière Séche, Matière Volatile Soluble	5 J
Eau gachage béton <b>selon la norme NF EN 1008</b>	Essais préliminaires + Essais chimiques	12 J

<b>IG Indices globaux Eaux usées Indices Globaux Eau de Rejet</b>	DBO, DCO, MESF	10 J
<b>LEGIOECS_CAMPHOT - LEGIONELLES (Forfait Plv+recherche) Recherche et dénombrement de Legionelles et Legionella pneumophila</b>	Legionella spp, Legionella pneumophila (sérogroupe)	11 à 13 J
<b>VIS - VISITES Analyses Eaux usées Station d'Epuration</b>	DBO5, DCO, MESF, NGL (NTK+ NO2+NO3), PT50	10 J
<b>AUTOSURVEILLANCE Analyses Eaux usées Station d'Epuration</b>	DBO, DCO, MESF, NGL (NTK + NO2 + NO3), NH4, PT50	10 J
<b>CS-PERMISS DE CONSTRUIRE Eaux destinées à l'usage personnel d'une famille</b>	Permis de construire pour certificat d'urbanisme (forfait prélèvement inclus)	10 J

---

VA01 Valeur Agronomique Boues <b>Valeur Agronomique de boues</b>	Humidité/Matière sèche, Matière minérale, Matière organique, Carbone organique Total, Azote Ammoniacal, Azote Total, Rapport C/N, K exprimé en K <sub>2</sub> O/MS, Ca exprimé en CaO/MS, Mg exprimé en MgO/MS, P exprimé en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /MS, Na exprimé en Na <sub>2</sub> O /MS, Minéralisation, Broyage, pH.	15 J
VA02 Boues (avec PCB, HPA) <b>Valeur Agronomique et organique de boues + éléments traces métalliques</b>	Aluminium, Bore, Soude, Potasse, Chaux, Magnésie, Cadmium, Carbone organique total, Chrome, Cuivre, Mercure, HPA, Matière sèche, Matière organique, Azote amoniacal, Nickel, Azote Total Kjeldhal, Plomb, PCB, pH, Phosphore total, Zinc.	30 J

---

## Environnement/Qualité de l'eau/Echantillonnage – Prélèvement

### Mesures Terrain

Caractéristiques mesurés ou recherchés	Référence de la méthode	Cofrac
<b>Eaux douces et résiduaires</b>		
<b>pH</b>	NF EN ISO 10 523	C
<b>Conductivité</b>	NF EN 27888	C
<b>Température</b>	Méthode interne 5TEMPEAU.doc	C
<b>Eaux douces</b>		
<b>Oxygène dissous</b>	NF EN ISO 5814	C
<b>Chlore Libre et Total</b>	NF EN ISO 7393-2	C
<b>Bioxyde de Chlore (ClO<sub>2</sub>)</b>	Procédure interne 5bioxydechlore**.doc	
<b>Turbidité</b>	NF EN ISO 7027-1	C
<b>Acide isocyanurique</b>	Méthode interne 5STAB.doc (Protocole PALINTEST)	C
<b>Potentiel REDOX</b>	NFT90-260	

C : paramètre accrédité COFRAC  
 Accréditation n°1-1706 Essais, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Eaux destinées à la consommation humaine, Eaux de loisirs naturelles, Eaux de loisirs traitées (eaux de piscines ...), Eaux superficielles continentales (eaux de rivières, lacs...), Eaux résiduaires, Eaux souterraines, Eaux douces. Eaux pour soins standards, Eaux bactériologiquement maîtrisées. Echantillons relatifs à l'Hygiène alimentaire.**

<b>Frais de prestations liés à l'acte de prélever</b>
Par pas de 1/4 heure - Temps Technicien
Temps Technicien (inclus dans le prix forfaitaire des analyses de recherche de légionnelles)
<b>Eaux résiduaires, Eaux souterraines ...</b>
Journée technicien Prélèvement asservis *
3/4 Journée technicien Prélèvement asservis (avec rapport écrit)
1/2 Journée technicien Prélèvement asservis (avec rapport écrit)
1/3 Journée technicien Prélèvement asservis (avec rapport écrit)
1/4 Journée administratif
Prélèvement eau souterraine (par échantillons) avec rapport écrit
Aveyron Labo est habilité pour la réalisation de diagnostic de fonctionnement des dispositifs de suivi régulier des rejets
1 Journée technicien Prélèvement asservis pour 1 STEP
1,5 Journée technicien Prélèvement asservis pour 2 STEP
2 Journées technicien Prélèvement asservis pour 3 STEP
2.5 Journées technicien Prélèvement asservis pour 4 STEP
<b>COURS D'EAU</b>
Mesure de débit avec un courantomètre

<b>Prestations</b>
Forfait matériel prélèvement asservi Débitmètre enregistreur/jour Préleveur automatique/jour Enregistrement continu T° et Ph par jour Enregistrement temps de fonctionnement
<b>Prestations</b>
<b>URGENCE</b>
intervention (urgence) - hors appel d'offres